

2014年11月  
No.14-144a(本)※5

## 検査内容変更のお知らせ

拝啓 時下益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。  
平素は格別のお引き立てをいただき、厚くお礼申し上げます。

さて、この度、下記検査項目におきまして、検査内容を変更させていただきたくご案内いたします。

何卒ご了承賜りますようよろしくお願ひ申し上げます。

敬具

### 記

#### ■対象項目/変更内容

頁	項目コード	検査項目名	変更内容	新	旧	備考
4	2517	アミラーゼ アイソザイム <血清>  アミラーゼ アイソザイム <尿>	検査方法	アガロース電気泳動法	セルロースアセテート膜電気泳動法	現測定試薬の製造販売中止とともに、測定機器ならびに測定試薬の変更。
			基準値(単位)	血清 TOTAL-S 36.0~84.3(%) TOTAL-P 15.7~64.0(%) 尿 TOTAL-S 17.7~61.3(%) TOTAL-P 38.7~82.3(%)	血清 TOTAL-S 35~79(%) TOTAL-P 21~65(%) 尿 TOTAL-S 12~59(%) TOTAL-P 41~88(%)	
	2535		報告範囲	血清 尿 0.0~100.0	血清 尿 0~100	

※新旧二法の相関は裏面をご参照下さい。

#### ■変更期日

●2015年1月5日(月)受付日分より


以上

## アミラーゼアイソザイム

本検査の委託先おきまして、現測定試薬の製造販売中止にともない、測定機器および測定試薬を変更させていただきます。併せて、検査方法、基準値、報告範囲を変更させていただきます。基準値はメーカー設定値です。

項目コード	検査項目名	変更内容	新	旧
2517 2535	アミラーゼアイソザイム <血清>  アミラーゼアイソザイム <部分尿>	検査方法	アガロース電気泳動法	セルロースアセテート膜電気泳動法
			血清 TOTAL-S 36.0～84.3(%) TOTAL-P 15.7～64.0(%) 尿 TOTAL-S 17.7～61.3(%) TOTAL-P 38.7～82.3(%)	血清 TOTAL-S 35～79(%) TOTAL-P 21～65(%) 尿 TOTAL-S 12～59(%) TOTAL-P 41～88(%)
		報告範囲	血清 尿 0.0～100.0	血清 尿 0～100

### ■新旧二法の相関

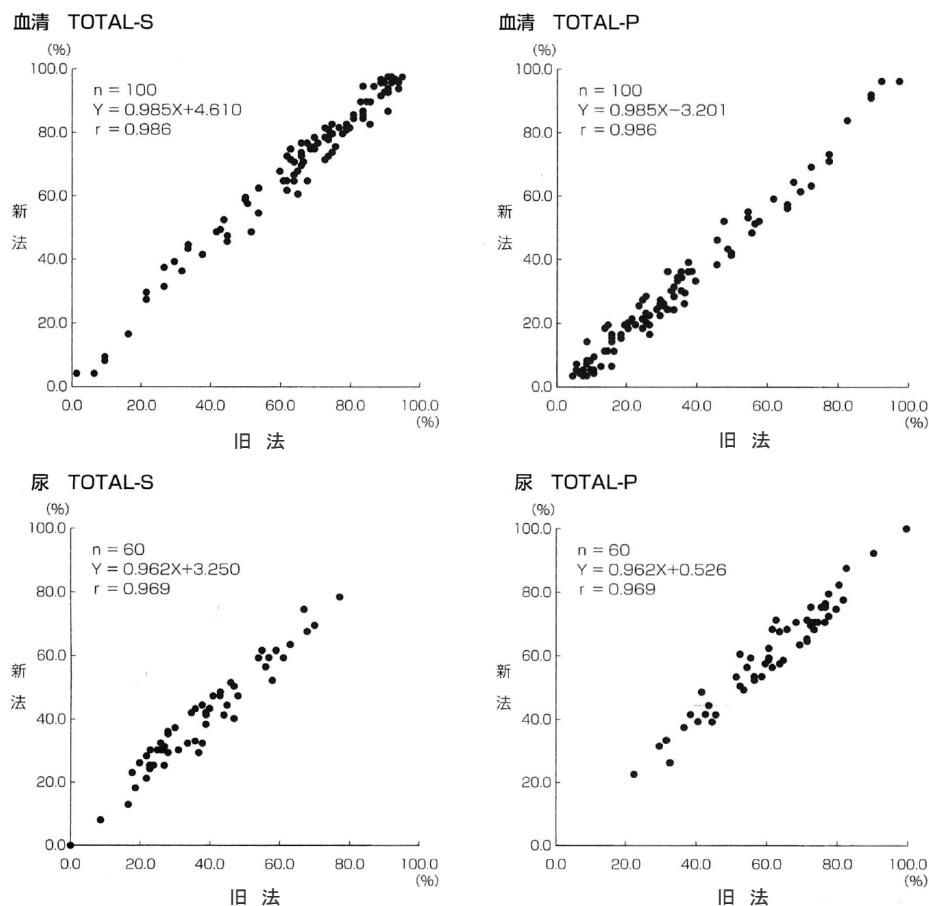

### ●新検査方法参考文献

星野 忠:JJCLA 37(3):293～297, 2012.