

## 検査内容変更のお知らせ

拝啓 時下益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。  
平素は格別のお引き立てをいただき、厚くお礼申し上げます。

さて、この度、下記検査項目におきまして、検査内容を変更させていただきたくご案内いたします。

何卒ご了承賜りますようお願い申し上げます。

敬具

## 記

### ■対象項目

- [2127] サイログロブリン
- [1803] ビタミンB<sub>1</sub>
- [ — ] ネオプテリン

※変更内容は裏面の変更内容一覧をご参照下さい。

### ■変更期日

- 2014 年 12 月 29 日(月)受付日分より

以上

## ■変更内容一覧


頁	項目 コード	検査項目名	変更内容	新	旧	備考
48	2127	サイログロブリン	基準値 (単位)	33.7 以下 (ng/mL)	32.7 以下 (ng/mL)	より感度の高い改良試薬への変更。 基準値、報告範囲の変更。
			報告範囲	0.04 未満 0.04～499 500 以上	0.1 以下 0.2～999 1000 以上	
122	1803	ビタミンB <sub>1</sub>	検体量 (mL)	血液 0.5	血液 1.0	検体量の見直しによる検体量の削減。
128	-	ネオプテリン	検体量 (mL)	血清 0.3 (部分尿を削除)	血清 0.3 部分尿 1.5	ご依頼のない尿材料を削除させていただきます。
			基準値 (単位)	血清 2～8 (pmol/mL) (部分尿を削除)	血清 2～8 (pmol/mL) 尿 0.21 以下 (mmol/mol・CRE)	
			報告範囲	血清 1 以下 2～99999999 (部分尿を削除)	血清 1 以下 2～99999999 部分尿 0.01 以下 0.02～99999.99	

## サイログロブリン

本検査の委託先におきまして、より感度の高い改良新試薬に変更させていただきます。  
併せて、基準値、報告範囲、検査方法参考文献を変更させていただきます。基準値は文献値です。

項目コード	検査項目名	変更内容	新	旧
2127	サイログロブリン	基準値 (単位)	33.7 以下 (ng/mL)	32.7 以下 (ng/mL)
		報告範囲	0.04 未満 0.04～499 500 以上	0.1 以下 0.2～999 1000 以上

### ■新旧二法の相関

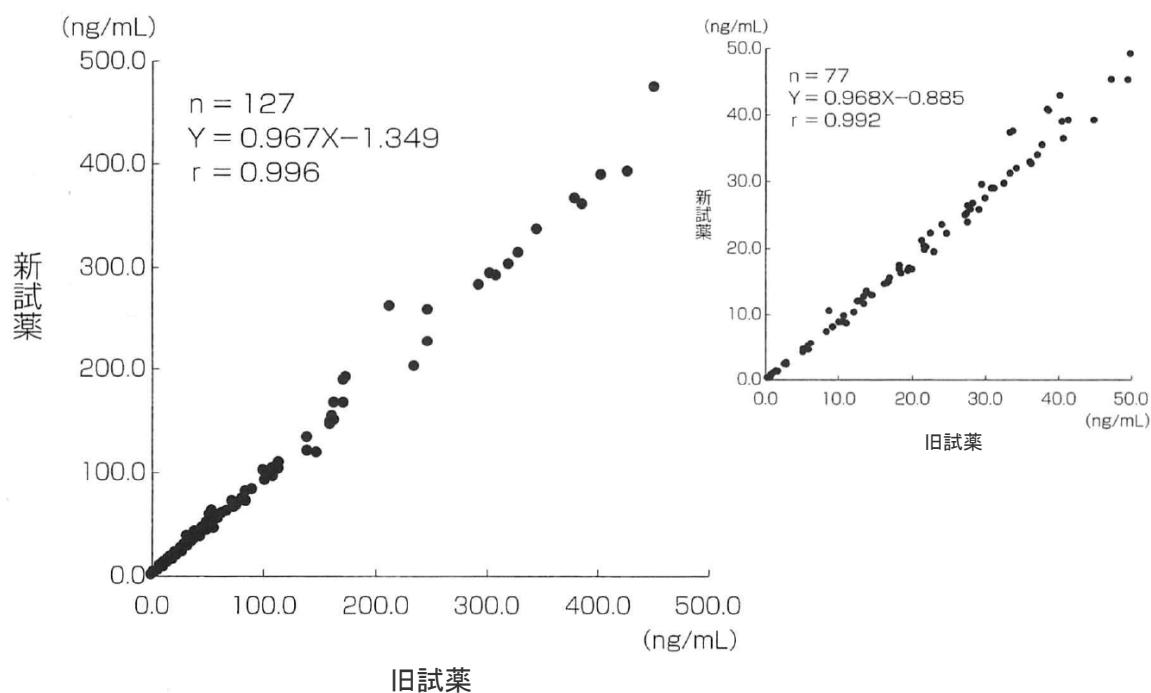

### ●新検査方法参考文献

北川 亘, 他: 医学と薬学 71(9):1655～1666, 2014.