

検査内容変更のお知らせ

拝啓 時下益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。
平素は格別のお引き立てをいただき、厚くお礼申し上げます。

さて、この度、下記検査項目におきまして、検査内容を変更させていただきたくご案内いたします。

何卒ご了承賜りますようお願い申し上げます。

敬具

記

■対象項目/変更内容

頁	項目 コード	検査項目名	変更内容	新	旧	備考
110	2517	アミラーゼ アイソザイム 〈血清〉	検査方法	アガロース電気泳動 法	セルロースアセート 膜電気泳動法	現測定試薬 の製造販売 中止にともな う、測定機器 ならびに測定 試薬の変更。
			基準値 (単位)	血清 TOTAL-S 36.0～84.3(%) TOTAL-P 15.7～64.0(%)	血清 TOTAL-S 35～79(%) TOTAL-P 21～65(%)	
				尿 TOTAL-S 17.7～61.3(%) TOTAL-P 38.7～82.3(%)	尿 TOTAL-S 12～59(%) TOTAL-P 41～88(%)	
			報告範囲	血清 尿 0.0～100.0	血清 尿 0～100	

※新旧二法の相関は裏面をご参照下さい。

■変更期日

●2015 年 1 月 5 日(月)受付日分より





以上

アミラーゼアイソザイム

本検査の委託先おきまして、現測定試薬の製造販売中止にともない、測定機器および測定試薬を変更させていただきます。併せて、検査方法、基準値、報告範囲を変更させていただきます。基準値はメーカー設定値です。

項目コード	検査項目名	変更内容	新	旧
2517	アミラーゼアイソザイム 〈血清〉	検査方法	アガロース電気泳動法	セルロースアセテート膜電気泳動法
2535	アミラーゼアイソザイム 〈部分尿〉	基準値 (単位)	血清 TOTAL-S 36.0～84.3(%) TOTAL-P 15.7～64.0(%) 尿 TOTAL-S 17.7～61.3(%) TOTAL-P 38.7～82.3(%)	血清 TOTAL-S 35～79(%) TOTAL-P 21～65(%) 尿 TOTAL-S 12～59(%) TOTAL-P 41～88(%)
		報告範囲	血清 0.0～100.0 尿	血清 0～100 尿

■新旧二法の相関

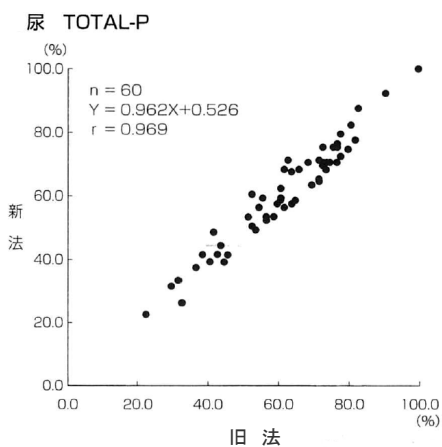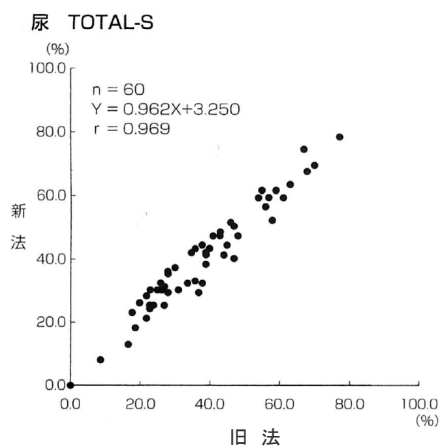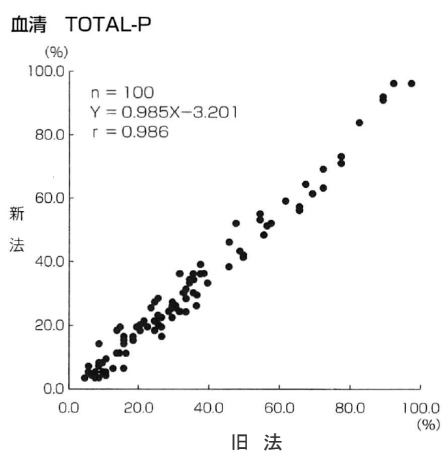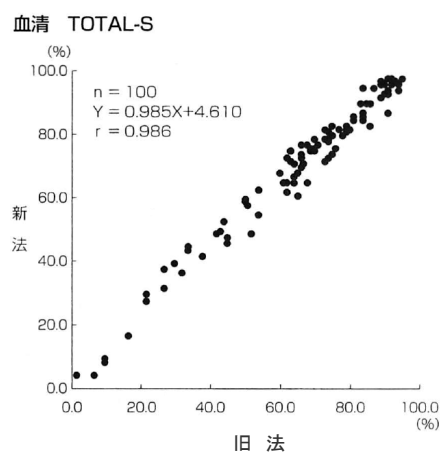

●新検査方法参考文献

星野 忠: JJCLA 37(3):293～297, 2012.