

2015年1月
No.15-014a(山)※5

「アンドロステンジオン」 検査内容変更のお知らせ

拝啓 時下益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。
平素は格別のお引き立てをいただき、厚くお礼申し上げます。

この度、下記項目の検査委託先より、測定試薬の販売中止に伴い2015年1月29日より再委託となる旨の連絡がございました。これに伴い、当該項目の検査内容を下記の通り変更させていただきますので、取り急ぎご案内致します。

誠に勝手ではございますが、事情をご賢察の上、何卒ご了承の程お願い申し上げます。
敬具

記

■対象項目/変更内容

項目 コード	検査項目名	変更内容	新	旧
53 2192	アンドロステンジオン	検査方法	RIA 硫安塩析法	RIA 固相法
		基準値	別掲参照	別掲参照
		報告範囲	0.10未満、0.10~99999999	0.1以下、0.1~99000000
		検体量	血清 0.5mL	血清 0.4mL
		保存温度	凍結	冷蔵
		所要日数	8~15日	3~10日
		検査場所	あすか製薬メディカル	エスアールエル

■変更期日


●2015年1月29日(木)受付日分より

以上

■基準値

年齢	新(ng/mL)		旧(ng/mL)	
	男性	女性	男性	女性
20~29 歳	0.48~1.82	0.64~2.34	1.2~2.5	1.1~3.9
30~39 歳	0.42~1.52	0.57~2.24	1.0~3.2	0.9~3.5
40~49 歳	0.46~1.67	0.28~1.35	1.0~2.9	0.6~2.2
50~59 歳	0.41~1.57	0.25~1.21	1.0~2.5	0.3~2.1
60~ 歳	-	-	0.6~2.7	0.3~2.0

■新旧二法の相関

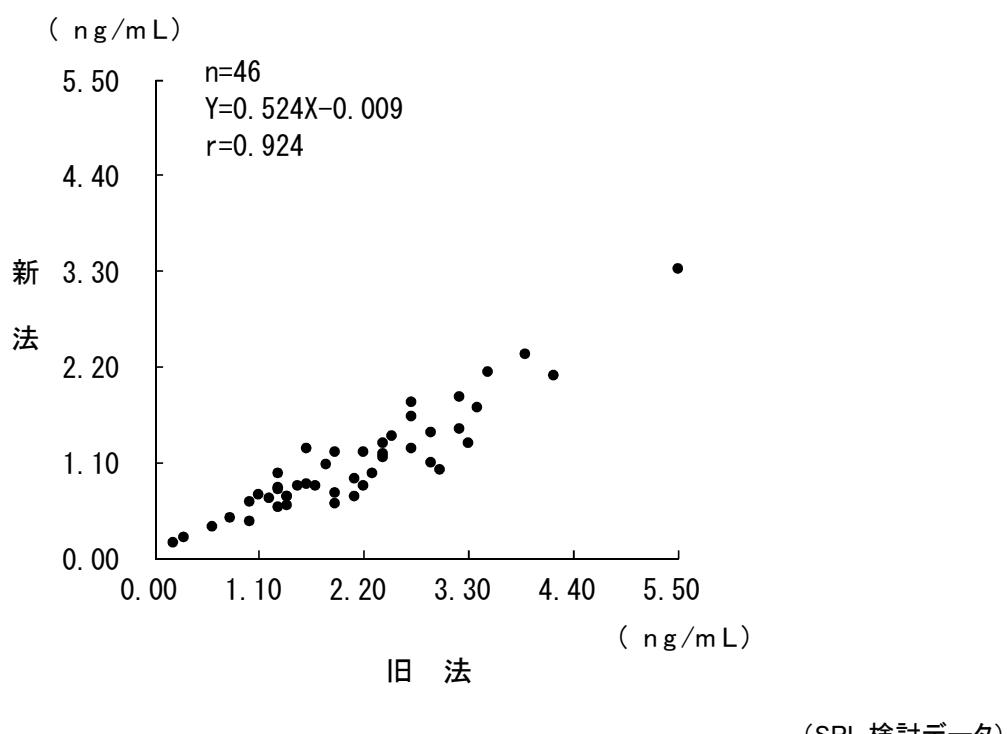

■新検査方法参考文献

吉田孝雄, 他:ホルモンと臨床, 22(5), 671~676, 1974.