

2016年9月  
No.16-098a(山)※1

## 検査内容変更のお知らせ

拝啓 時下益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。  
平素は格別のお引き立てをいただき、厚くお礼申し上げます。

さて、この度、下記項目につきまして検査内容を変更させていただきますので、取り急ぎご案内する次第です。

誠に勝手ではございますが、事情をご賢察の上、何卒ご了承の程お願い申し上げます。

敬具

### 記

#### ■検査項目/変更内容

- 別掲の「検査内容変更一覧」をご参照下さい。

#### ■変更期日

- 2016年9月30日(金)受付日分より

以上

## ●検査内容変更一覧

頁	項目コード	検査項目名	変更箇所	新	旧	備考
60	2417	CA15-3	検査方法	CLIA [アボット ジャパン]	CLIA [シーメンスヘルスケア・ダイ アグノスティクス]	測定範囲が 広い試薬の 採用
			基準値	31.3 U/mL 以下	27.0 U/mL 以下	
			報告上限	4,000 U/mL 以上	500 U/mL 以上	
61	2415	CA125	検査方法	CLIA [アボット ジャパン]	CLIA [シーメンスヘルスケア・ダイ アグノスティクス]	測定範囲が 広い試薬の 採用
			報告上限	10,000 U/mL 以上	5,000 U/mL 以上	
			報告下限	1.0 U/mL 未満	2.0 U/mL 未満	
-	2923	麻疹:PA	保存方法	冷蔵	凍結	検査場所 変更(測定 試薬は変 更なし)
			報告上限	8,192 倍以上	∞ 倍	
			所要日数	4~7 日	6~9 日	
			検査委託先 (検査場所)	LSI メディエンス (LSI メディエンス)	LSI メディエンス (北里大塚バイオメデイ カルアッセイ研究所)	


※その他の検査要項に変更はございません。

## CA15-3 / CA125


CA15-3およびCA125の測定試薬を測定範囲が広いCLIA法試薬に変更いたします。本変更に伴い、CA15-3の基準値を測定試薬の添付文書記載値に変更いたします。

### ■新旧二法の相関

【CA15-3】

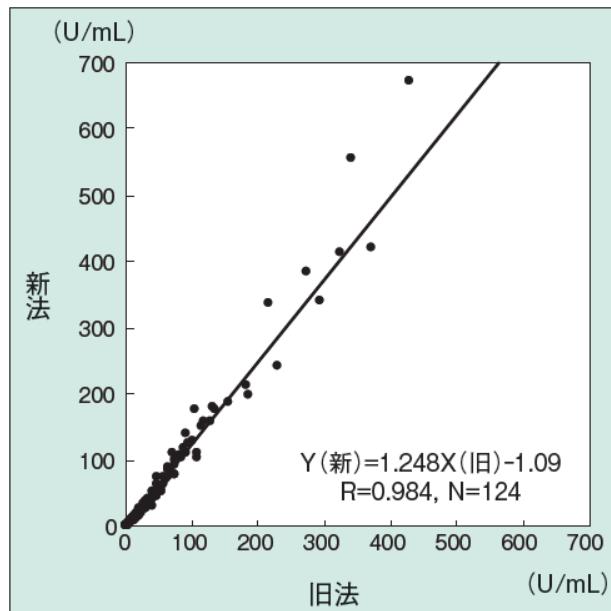

【CA125】

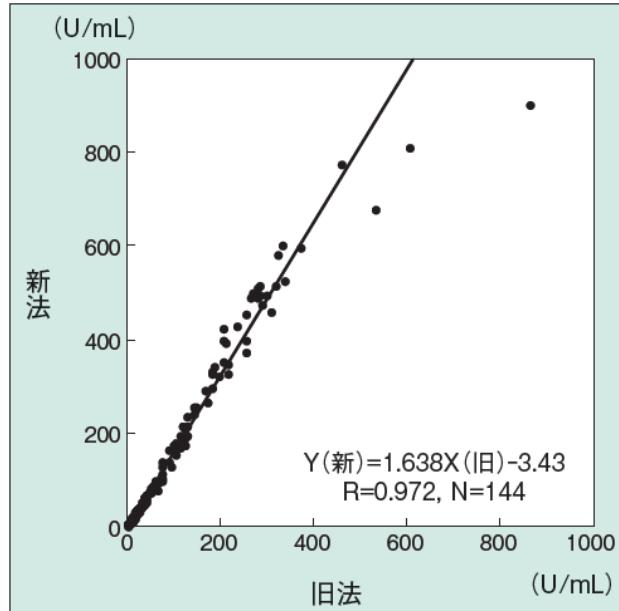

(LSIメディエンス 検討データ)