

「高感度 TNF- α 」 検査内容変更のお知らせ

拝啓 時下益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。
平素は格別のお引き立てをいただき、厚くお礼申し上げます。

さて、この度、標記項目の検査委託先より、改良新試薬の発売開始に伴い、現試薬が販売中止となる為、測定試薬を変更する旨の連絡がございました。

この試薬変更に伴い、検査内容変更させていただきたくご案内いたします。

誠に勝手ではございますが、事情をご賢察の上、何卒ご了承の程お願い申し上げます。

敬具

記

■検査項目/変更内容

頁	項目 コード	検査項目名	変更内容	新	旧
191	6907	高感度 TNF- α	検査項目名	TNF- α （高感度）	高感度 TNF- α
			基準値 （単位）	0.75～1.66（参考値） （pg/mL）	0.6～2.8（参考値） （pg/mL）
			報告範囲	0.15 未満、 0.15～999000	0.5 以下、 0.6～999000

※その他の検査要項に変更はございません。

新旧二法の相関につきましては、裏面をご確認下さい。

■変更期日

●2017 年 5 月 31 日（水）受付日分より


以上

高感度 TNF- α

測定試薬の製造販売中止、より感度が向上された改良新試薬の発売に伴い、測定試薬を変更させていただきます。

新基準値は、メーカー参考値です。

■新旧二法の相関

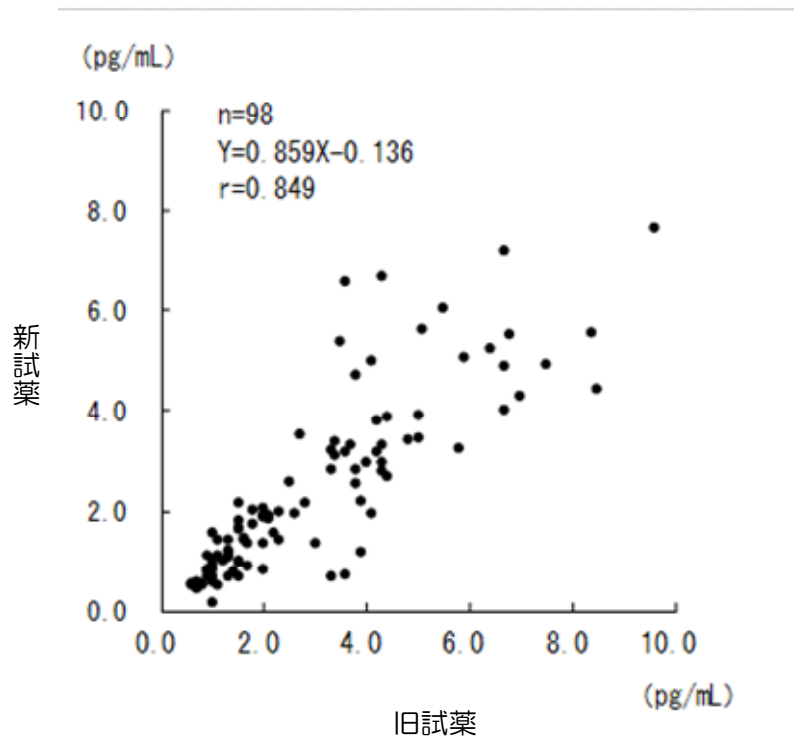

(エスアールエル検討データ)