

2017年11月
No.17-159a(山)

検査内容変更のお知らせ

拝啓 時下益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。
平素は格別のお引き立てをいただき、厚くお礼申し上げます。

さて、この度、尿検査などに使用する蛋白定量試薬を、従来の用手法用から自動分析装置用へ変更することとしました。

つきましては、この試薬変更による検査内容変更をご案内いたします。
誠に勝手ではございますが、事情をご賢察の上、何卒ご了承の程お願い申し上げます。
敬具

記

■対象項目/変更内容

| 頁 | 項目コード | 検査項目名 | 変更箇所 | 新 | 旧 |
|-----|-------|----------------|-------|-----------------------|---------------------|
| 140 | 7015 | (尿検査) 蛋白定量 | 検査方法 | ピロガロール・レット法 自動分析機用 | ピロガロール・レット法 用手法用 |
| | | | 報告値下限 | 3 mg/dL ^{*1} | なし |
| 141 | 7206 | (髄液検査) 蛋白定量 | 検査方法 | ピロガロール・レット法 自動分析機用 | ピロガロール・レット法 用手法用 |
| | | | 報告値下限 | 3 mg/dL ^{*1} | なし |

* 1: 報告値下限を下回った場合は「3 未満」と報告し、蛋白定量 1 日量・尿蛋白/クレアチニン比を計算不可と報告いたします。

※その他の検査要領に変更はございません。


※新旧二法の相関は裏面をご参照下さい。

■変更期日

●2017年11月20日(月)受付日分より

以上

■新旧二法の相関

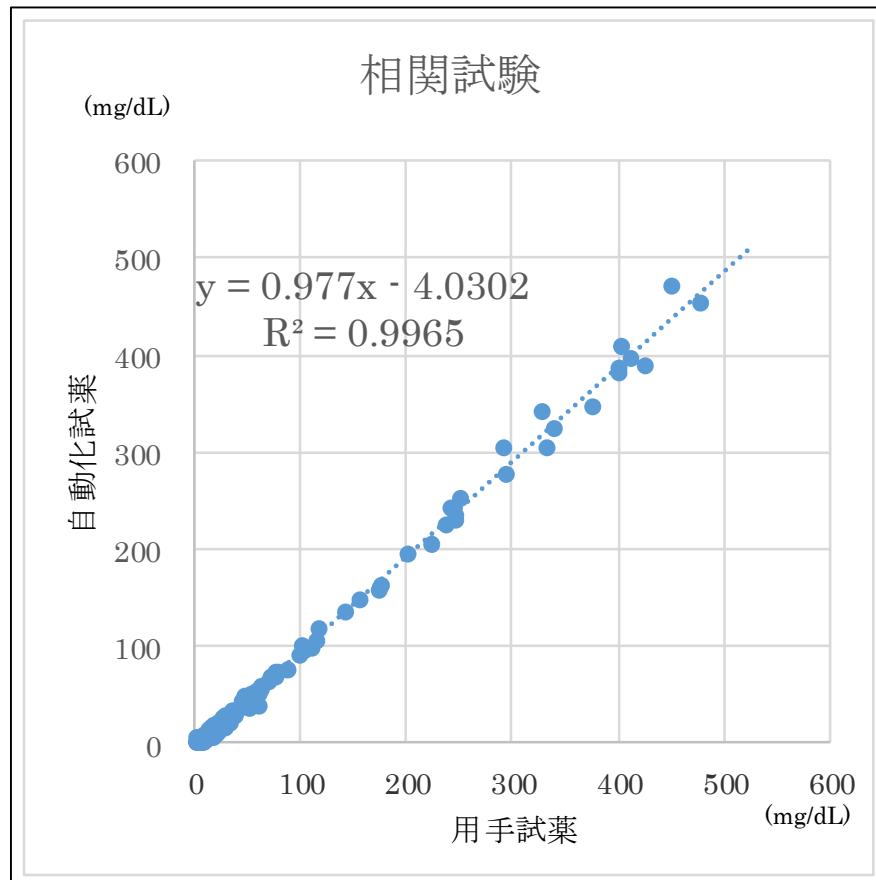

(自社検討データ)