

2018年2月
No.18-012a(本)

検査内容変更のお知らせ

拝啓 時下益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。
平素は格別のお引き立てをいただき、厚くお礼申し上げます。

さて、この度、HBs抗体測定試薬の仕様変更に伴い、下記のとおり検査内容変更をご案内いたします。

誠に勝手ではございますが、事情をご賢察の上、何卒ご了承の程お願い申し上げます。

敬具

記

■対象項目/変更内容

頁	項目コード	検査項目名	変更箇所	新	旧
59	3124	HBs 抗体 《精密測定》	基 準 値	10.0 未満(mIU/mL) 根拠を明確化 ^{*1}	10.0 未満(mIU/mL) 根拠表現無し
			報告可能範囲	2.5~1000.0 ^{*2}	10.0~1000.0

※他の検査要項に変更はございません。

※今回の仕様変更では、測定値の値付けを行うWHO 標品が 1st から 2nd に変更されました。これにより、測定値が高値傾向となります。

※新旧二法の相関は裏面をご参照下さい。

* 1: 10.0mIU/mL は、HBV ワクチンの再接種基準のためのカットオフ値です(最少防御抗体価)。

* 2: 報告範囲の下限が 10.0 から 2.5 に拡大されます。従来「10.0 未満」と報告されているものは、2.5 までが実数報告となり、2.5 を下回る場合に「2.5 未満」と報告いたします。また、定性判定は *1 に従い、10.0 未満を陰性(ー)と判定いたします。


■変更期日

●2018年4月2日(月)受付日分より

■新旧二法の相関

【全体】

(n=52)

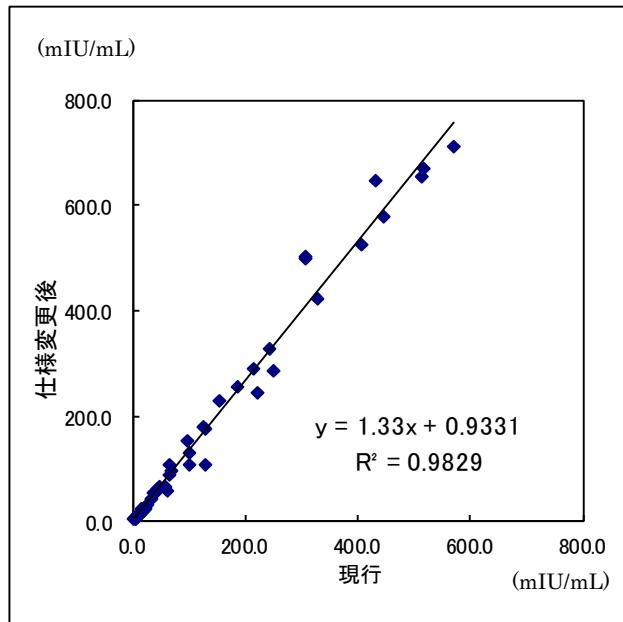

【低値域】

(n=26)

